

「B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

- 3157 B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)

変更内容	新	旧	検査案内 掲載頁
基準値	2.1未満	3.0未満	P.59
単位	LogU/mL	同左	
報告範囲	2.1未満、2.1～7.0、7.1以上	3.0未満、3.0～6.7、6.8以上	
報告桁数	有効3、整数8、小数1	有効2、整数1、小数1	

変更期日


- 令和4年10月8日(土)受付日分より

●B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)

新たに発売された高感度試薬へ変更させていただきます。
これに伴い、基準値、報告範囲を変更いたします。

エスアールエル検討データ

▼現法と新法の比較

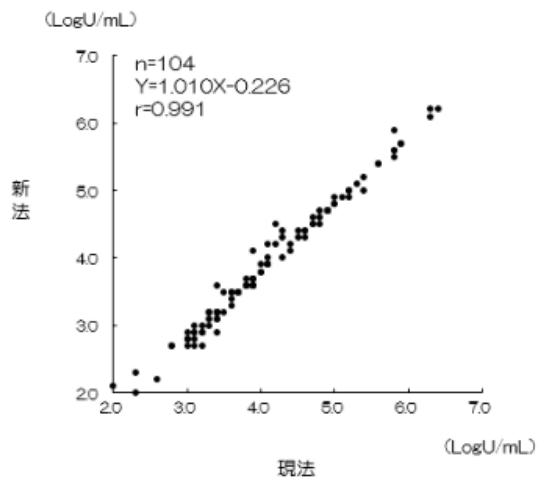

		現法	
		陽性 <3.0LogU/mL	陽性 ≥3.0LogU/mL
新法	陽性 <2.1LogU/mL	8	0
	陽性 ≥2.1LogU/mL	6	98

一致率：94.6% (n=112)

●参考文献

Inoue T, et al: J Hepatol 75(2):302~310, 2021. (検査方法参考文献)