

病理組織検査容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「総合検査のご案内」でご案内しております病理組織検査用の組織片容器について、容器の調達が困難となったため現在庫が無くなり次第、順次変更させていただきたくご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	案内書掲載頁
252	病理組織顕微鏡検査	P. 120


裏面参照

変更期日


- 令和4年 10月中旬より

病理組織検査用組織片容器：47番

「総合検査のご案内」のP.120に掲載しております「容器番号47のS-100とS-140」につきまして、S-100容器を病理容器3号に、またS-140容器を病理容器Lへ変更させていただきます。

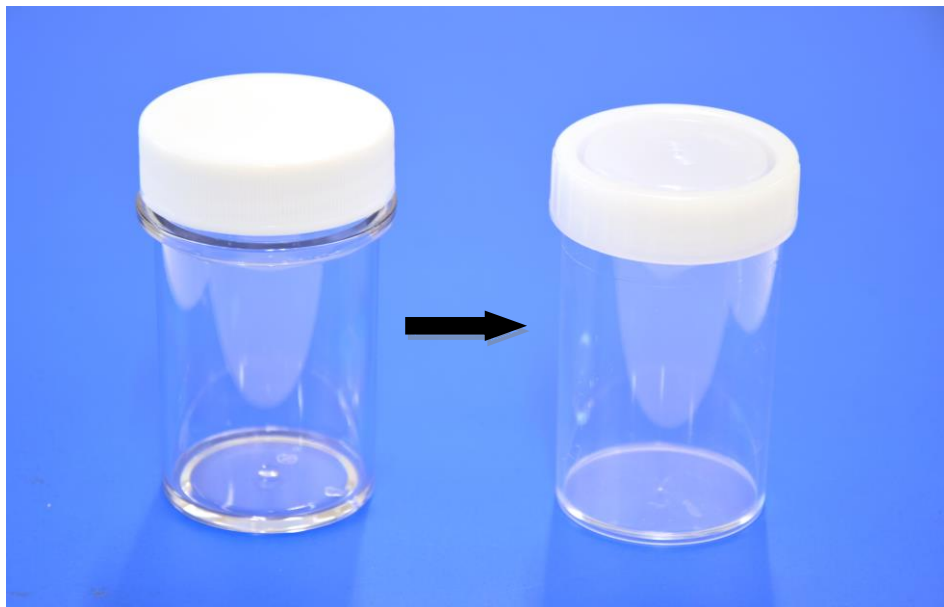

S-100 容器 (Φ5cm 容量 100mL) → 病理容器 3号 (Φ4.4cm 容量 70mL)

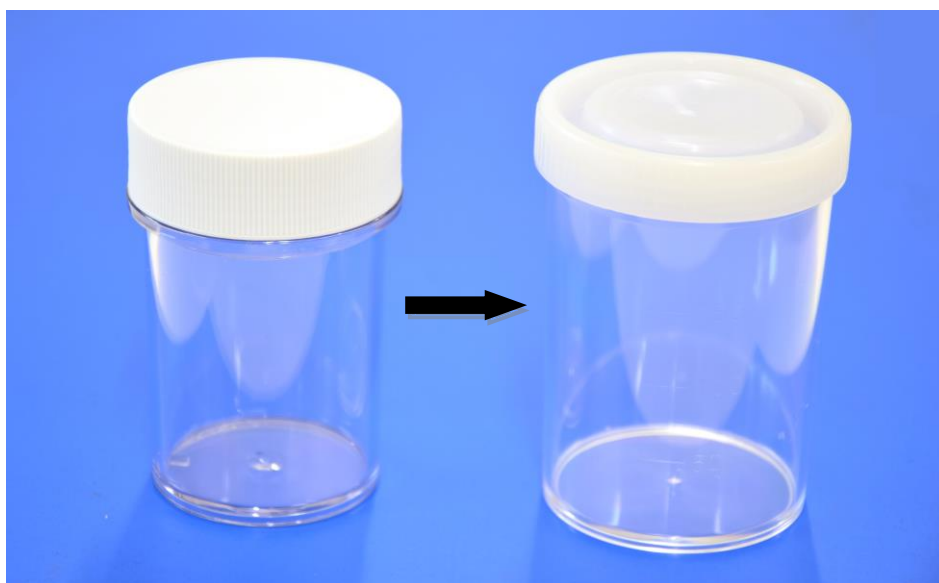

S-140 容器 (Φ6cm 容量 140mL) → 病理容器 L (Φ6.35cm 容量 200mL)