

病理組織検査容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「総合検査のご案内」でご案内しております病理組織検査用の組織片容器について、容器の調達が困難となったため現在庫が無くなり次第、順次変更させていただきたくご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	案内書掲載頁
252	病理組織顕微鏡検査	P. 120


裏面参照

変更期日


- 令和4年 12月下旬より

病理組織検査用組織片容器：47番

「総合検査のご案内」のP.120に掲載しております「容器番号47のNo.1とNo.2」につきまして、No.1容器を病理容器XSに、またNo.2容器を病理容器1号へ変更させていただきます。現在、箱での包装でお届けしていますが、袋包装でのお届けとなります。

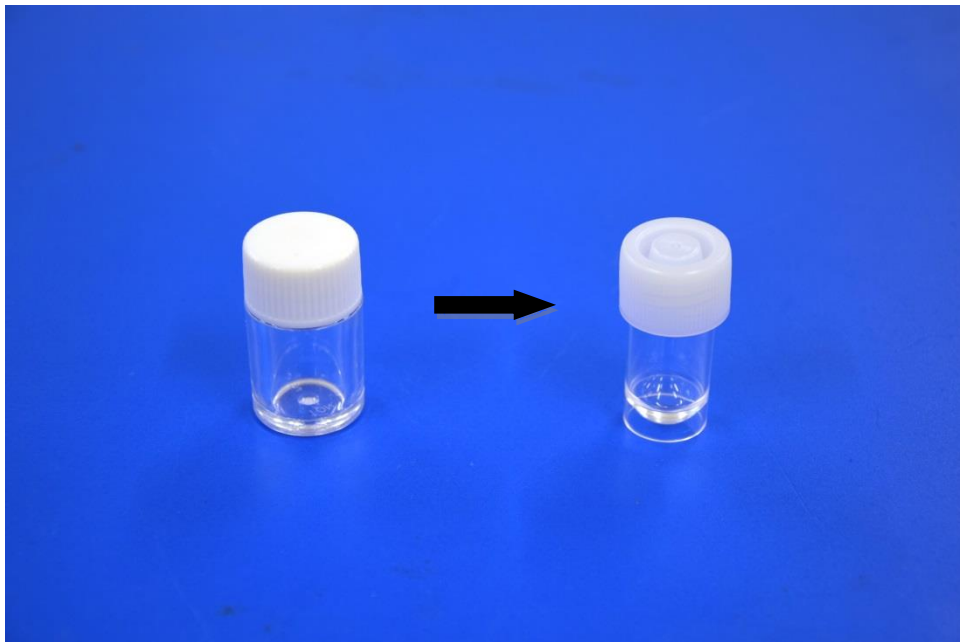

No.1容器 (Φ22 mm 5cc) → 病理容器 XS (Φ18 mm 4cc)

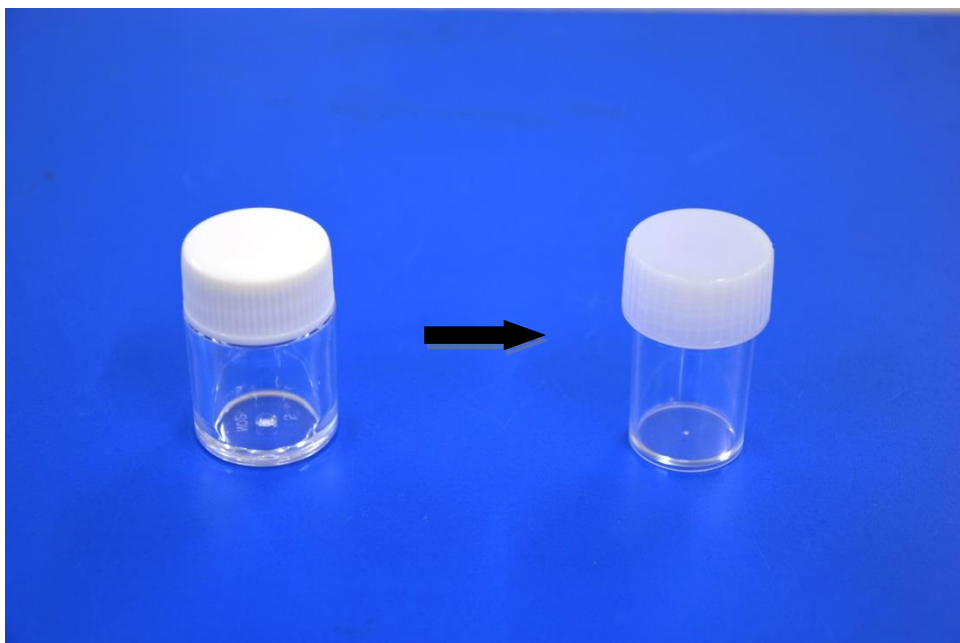

No.2容器 (Φ30 mm 10cc) → 病理容器 1号 (Φ24.5 mm 10cc)