

「プレグナンジオール(P2)、プレグナントリオール(P3)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考 (総合検査のご案内)
728	プレグナンジオール(P2)	検査方法 検体量	LC-MS/MS 蓄尿 2 mL	GC-MS/MS 蓄尿 5 mL	検査方法の変更 P.43
729	プレグナントリオール(P3)	検査方法 検体量	LC-MS/MS 蓄尿 2 mL	GC-MS/MS 蓄尿 5 mL	

変更期日

- 令和5年3月31日(金)受付日分より

●プレグナンジオール(P₂)、プレグナントリオール(P₃)


検査方法をGC-MS/MS法からLC-MS/MS法に変更いたします。新法では少ない検体量で検査が可能となります。

なお、新旧二法の相関は良好であり、基準値に変更はございません。

LSI メディエンス検討データ

●相関図

[P₂]

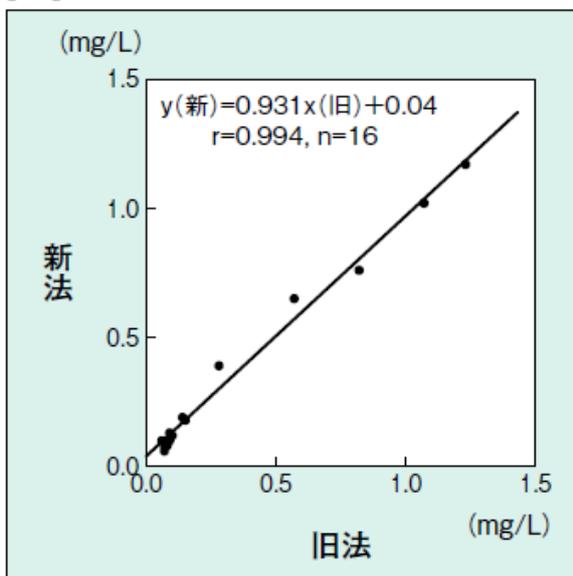

[P₃]

